


Carbon monoxide

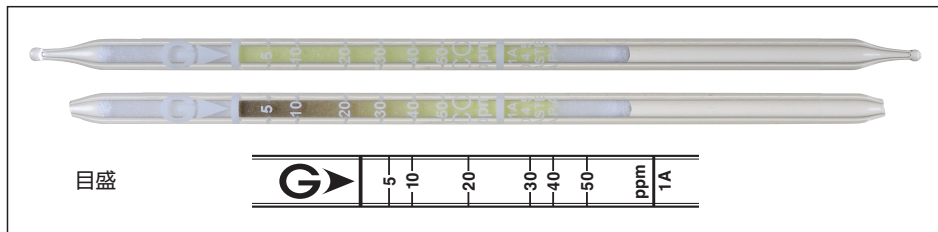

仕 様 呼吸用圧縮空気中（ボンベまたはコンプレッサー）の一酸化炭素を測定可能。

測定範囲	5 ～ 50 ppm
通気速度・流量	100 mL/min (300 mL)
測定所要時間	3 分
係 数	1

変 色： 黄色 → 黒褐色

温・湿度補正： なし

有効期間： 36 か月

変動係数：

G▶	CV=10%	CV=5%
	目盛範囲の1/3	目盛範囲の2/3

(CV：変動係数 = σ ：標準偏差 ÷ 平均値 × 100)

反応原理

一酸化炭素により亜硫酸パラジウムナトリウムが還元され、金属パラジウムを析出し、黒褐色を呈する。



校正用ガス

高圧ガス容器詰法