

GASTEC Istruzioni per l'uso della No.123TP Fiala di rilevazione di xilene

PER LA SICUREZZA:

Leggere attentamente questo manuale e il manuale di istruzioni della pompa di campionamento aria.

⚠ ATTENZIONE: La mancata osservanza delle seguenti precauzioni potrebbe causare lesioni o danni al prodotto.

1. Quando si spezzano le estremità delle fiale, tenerle lontane dagli occhi.
2. Non toccare le fiale di vetro rotte, i frammenti rotti e il reagente a mani nude.

⚠ NOTE: Per mantenere le prestazioni e l'affidabilità dei risultati dei test, osservare quanto segue.


1. Viene raccomandato l'uso del dispositivo di campionamento gas Gastec Modello GSP-300FT-2 (se non disponibile, utilizzare la pompa di campionamento dell'aria equivalente al campione per 100 mL/min) insieme alle fiale di rilevazione Gastec solo per gli scopi specificati nel manuale di istruzioni della fiala di rilevazione.
2. Assicurarsi che la fiala primaria sia collegata correttamente con una fiala di analisi prima dell'uso. Se utilizzato senza fiala primaria, non solo vengono forniti risultati errati, ma il materiale acido contenuto nella fiala di rilevazione danneggia anche la pompa.
3. Utilizzare la fiala nell'intervallo di temperatura di 0 - 40 °C (32 - 104 °F).
4. Utilizzare la fiala entro l'intervallo di umidità relativa di 0 - 90%.
5. Questa fiala potrebbe subire interferenze dai gas coesistenti. Fare riferimento alla tabella "INTERFERENZE".
6. Periodo di validità e condizioni di conservazione della fiala sono indicati sull'etichetta della scatola della fiala.

APPLICAZIONE DELLA FIALA:

Questa fiala è dedicata al rilevamento di xilene nell'aria o nelle zone industriali nonché alla determinazione delle condizioni atmosferiche ambientali.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

(Poiché Gastec è impegnata nel continuo miglioramento dei prodotti, le loro caratteristiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso).

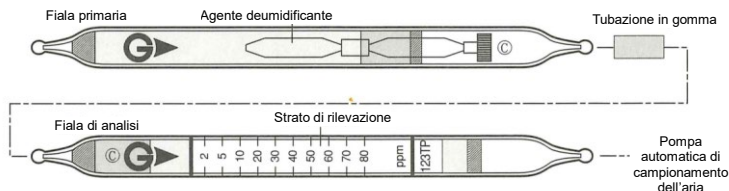

Campo di misura	2 - 80 ppm
Tasso di campionamento	100 mL/min
Fattore di correzione	1
Tempo di campionamento	10 minuti
Limite di rilevazione	1 ppm (1000 mL)
Variazione cromatica	Bianco → Marrone
Principio della reazione	$C_6H_4(CH_3)_2 + I_2O_5 + H_2SO_4 \rightarrow I_2$

Coefficiente di variazione: 10% (da 2 a 20 ppm), 5% (da 20 a 80 ppm)

****Validità:** fare riferimento alla data di validità stampata sulla scatola della fiala.

****Conservare le fiale in luogo fresco e al buio.**

CORREZIONE DELLA TEMPERATURA, DELL'UMIDITÀ E DELLA PRESSIONE:

Temperatura: Nessuna correzione necessaria.

Umidità: Nessuna correzione necessaria.

Pressione: Per correggere la pressione, moltiplicare la lettura della fiala con la seguente formula

$$\frac{\text{Lettura della fiala (ppm)} \times 1013 \text{ (hPa)}}{\text{Pressione atmosferica (hPa)}}$$

PROCEDURA DI MISURAZIONE:

se viene utilizzata la pompa di campionamento aria automatica Modello GSP-300FT-2

1. Prima dell'operazione, verificare se il portafiala di gomma di ingresso del colore nero è in dotazione con la pompa.
2. Spezzare le punte su una fiala primaria nuova e una fiala di analisi con l'apposito supporto punta fiala in dotazione.
3. Collegare le estremità contrassegnate con © al tubo di gomma dopo aver spezzato le estremità.
4. Inserire la fiala di analisi nell'entrata della pompa con la freccia (➔) sulla fiala rivolta verso la pompa.
5. Impostare il flussometro su 100 mL/min e il timer su "10 minuti" della pompa. Premere l'interruttore di avvio della pompa per avviare il campionamento.
6. Dopo il campionamento, rimuovere la fiala di rilevazione dalla pompa.
7. Leggere il livello di concentrazione all'interfaccia in cui il reagente colorato incontra il reagente non colorato.
8. Se necessario, moltiplicare le letture per i fattori di correzione della pressione atmosferica.

INTERFERENZE:

Sostanza	Concentrazione	Interferenza	Cambia colore da solo
Monossido di carbonio	≥ 75 ppm	Demarcazione non chiara	Marrone (≥ 50 ppm)
Etilbenzene	$\geq 1/3$	+	Marrone
Acetato di etile	≤ 400 ppm	No	Nessuno scolorimento
Diclorometano	≤ 30 ppm	No	Nessuno scolorimento
N,N-dimetilformammide	≤ 25 ppm	No	Nessuno scolorimento
Tricloroetilene	$\geq 1/2$	+	Nessuno scolorimento
Toluene	$\geq 1/3$	+	Marrone
n-Esano	≥ 200 ppm	Demarcazione non chiara	Nessuno scolorimento
Metanolo	≤ 200 ppm	No	Nessuno scolorimento

Questa tabella di gas di interferenza esprime principalmente l'interferenza di ciascun gas coesistente nella gamma di concentrazione del gas, che è equivalente alla concentrazione di gas. Pertanto, al risultato dei test potrebbe essere dato esito positivo dalle altre sostanze non elencate nella tabella. Se sono necessarie ulteriori informazioni, contattarci o contattare i rappresentanti Gastec.

PROPRIETÀ PERICOLOSE E RISCHI:

Valore limite di soglia - Media ponderata in base al tempo a cura di ACGIH (2015): 100 ppm

Valore limite di soglia - Limite di esposizione a breve termine a cura di ACGIH (2015): 150 ppm

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO:

Il reagente della fiala primaria non usa sostanze tossiche. Il reagente della fiala di analisi non usa sostanze tossiche. Quando si smaltisce la fiala, indipendentemente dal fatto che sia stata utilizzata o meno, seguire le norme e i regolamenti locali vigenti.

GARANZIA:

per qualsiasi domanda sulla rilevazione del gas e sulla qualità delle fiale, non esitare a contattare i rappresentanti Gastec.

Produttore: Gastec Corporation
8-8-6 Fukayanaka, Ayase-City, Kanagawa 252-1195, Giappone
<http://www.gastec.co.jp/>
Telefono + 81-467-79-3910 Fax + 81-467-79-3979

IM01123TPE2
Stampato in Giappone
18J/MP-IT